


VNI COVID-19

Fiche 1- Version 15 avril 2020




GAVO₂
Groupe assistance
ventilatoire et oxygène

Liste des consommables pour réaliser les montages recommandés par le GAVO²*


Ventilation Niveau 1 et 2 Circuit simple à fuite

Ex: Lumis, Dreamstation Avaps, Prisma 25/30ST, Vent 40/50...

Nom	Fabricant	Réf. Fabricant	Cdtnmt	Photo
Circuit 22mm simple	Intersurgical	5318000		
Filtre bactériologique (Jaune)	Intersurgical	1644000	Boite de 100	
Filtre HME (Vert-Humidif.)	Intersurgical	1541000		
Fuite intentionnelle	Intersurgical	5802001	Boite de 30	
Fuite intentionnelle avec valva anti-asphyxie	ResMed	24988	Unité	
Fuite intentionnelle	Lowenstein	WM23600		
Fuite intentionnelle Whisper swive II	Philips	332113		
Fuite intentionnelle WILAsilent	Breas	004426/007243		
Capuchon de sécurité 22F rouge (fig.3)	Intersurgical	1978000	Boite de 45	
Raccord en T M/F/M masque à fuite (fig.3)	Intersurgical	1981000	Boite de 20	
Raccord en T M/M/F masque sans fuite (fig.3)	Intersurgical	1982000	Boite de 20	
Raccord enrichissement Oxygène	Intersurgical	1963000	Boite de 25	

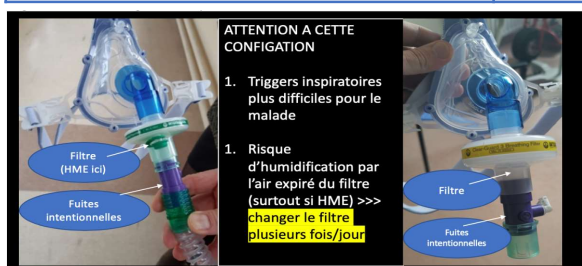

*Figure 3bis



*Figure 3

* En référence à : Appareillages respiratoires de domicile d'un malade suspect ou porteur de virus respiratoire